

お客様 各位

## 「ネオチューブ」包材変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が販売をしております真空密封型採血管『ネオチューブ』のオーバーキャップ品の包材変更を行います。

今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容：オーバーキャップ品（OP管）の内箱・外箱のサイズを変更します。

5mL管・7mL管でサイズが異なります。

アルミ包装品は変更の対象ではありません。

表記は横\*縦\*高さの順で寸法はmmです。

### 変更前

規格	内箱サイズ	外箱サイズ
オーバーキャップ 5mL 管	101 * 266 * 65	222 * 342 * 278
オーバーキャップ 7mL 管	120 * 266 * 66	257 * 347 * 278

### 変更後

規格	内箱サイズ	外箱サイズ
オーバーキャップ 5mL 管	90 * 300 * 70	191 * 364 * 314
オーバーキャップ 7mL 管	114 * 300 * 75	238 * 389 * 314

### 変更ロット

規格	変更ロット
オーバーキャップ 5mL 管	21L19E より変更
オーバーキャップ 7mL 管	21L17E より変更


### 変更時期

2022年1月以降

## オーバーキャップ 5mL 管内箱比較写真

変更後は横が短くなり、縦が長くなります。高さは変更後の箱の方が高くなります。

左：変更前 右：変更後

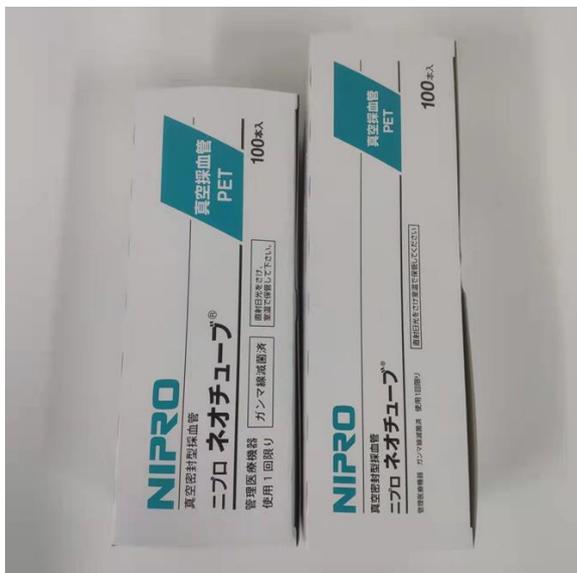

左：変更前 右：変更後



## オーバーキャップ 5mL 管外箱比較写真

変更後は横が短くなり、縦が長くなります。高さは変更後の箱の方が高くなります。

左：変更前 右：変更後



左：変更前 右：変更後




### オーバーキャップ 7mL 管内箱比較写真

変更後は横が短くなり、縦が長くなります。高さは変更後の箱の方が高くなります。

左：変更前 右：変更後

左：変更前 右：変更後

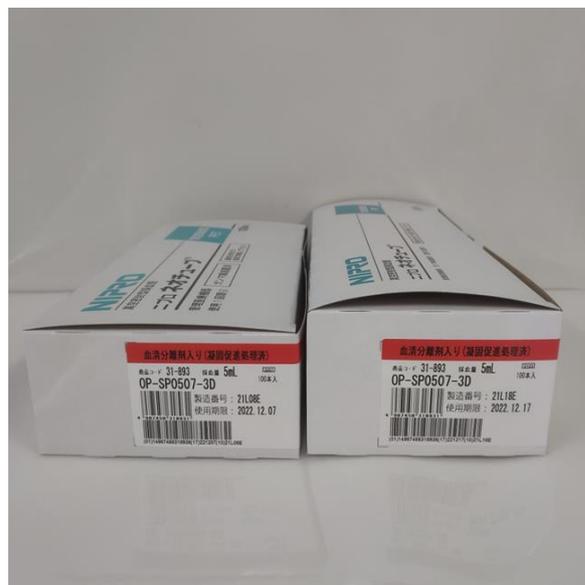

### オーバーキャップ 7mL 管外箱比較写真

変更後は横が短くなり、縦が長くなります。高さは変更後の箱の方が高くなります。

左：変更前 右：変更後

左：変更前 右：変更後

