

「ニプロCEサーモ」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、連続測定型耳式体温計「ニプロCEサーモ」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

引き続きご愛顧いただきますようお願い申し上げます。


敬具

変更内容

●モニターケーブルを変更しました。

(現行モニターケーブルの供給が不安定であったため、安定供給されるモニターケーブルに変更しました。)

●モニターケーブルの取り扱いに関する注意タグを付けました。

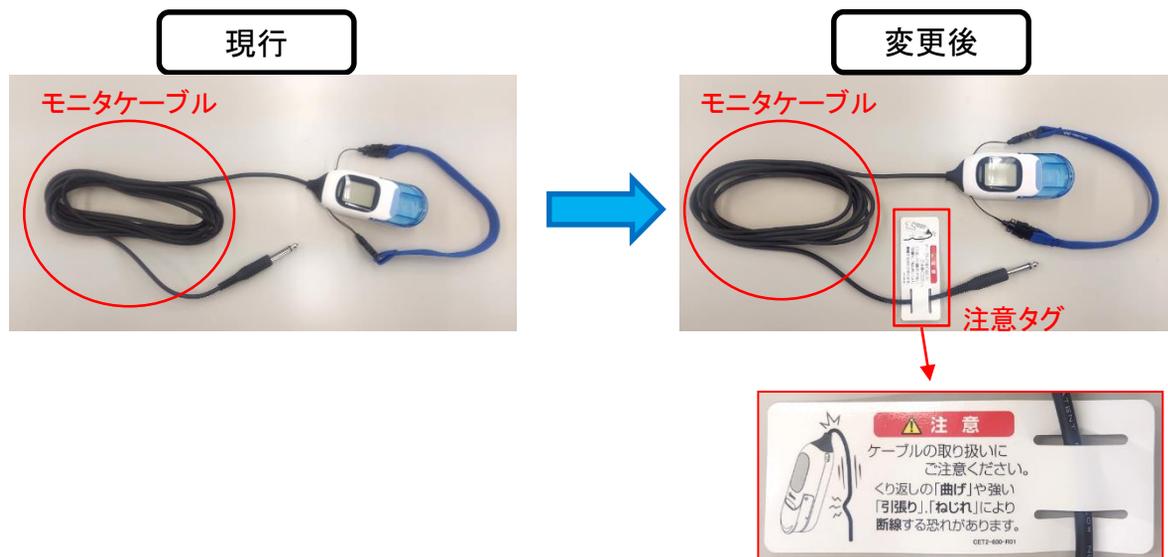

※製品機能に関する仕様変更はございません。

対象品番

JANコード	商品コード	商品名	変更ロット	流通時期
4987458431470	43-147	CEサーモ2 本体セット	TG22B	2022年7月頃

【販売名:連続測定型耳式体温計】