

一般用 SARS コロナウイルス抗原キット
「V トラスト® SARS-CoV-2 Ag（一般用）」スワブ変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「V トラスト® SARS-CoV-2 Ag（一般用）」に同梱しているスワブを下記のロットより変更することになりましたのでご案内申し上げます。


スワブが変更になってもキットの性能に影響はありません。

敬具

記

スワブ外観

変更前

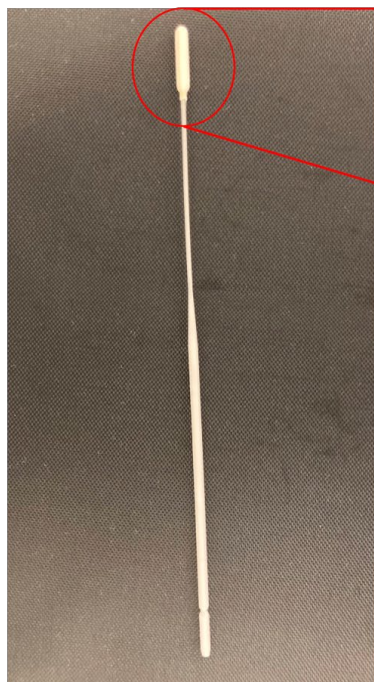


製造販売：ニプロ株式会社

一般医療機器/医科用捲綿子

医療機器届出番号：27B1X00045000092

販売名：ニプロスポンジスワブ

変更後

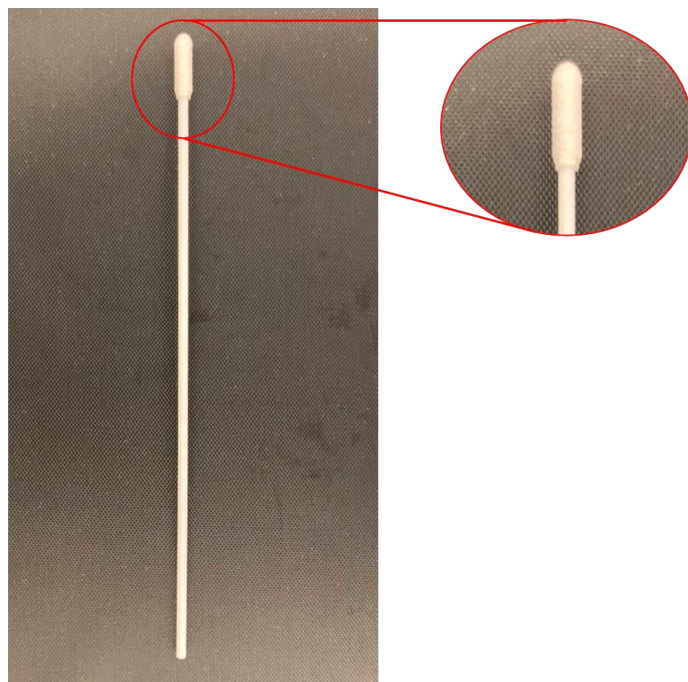

製造：Puritan Medical Products
Company LLC

変更ロット

Lot. 22K28 以降 ： Puritan 製造スワブ

以上