

**生物学的同等性試験**  
**アジルサルタン錠20mg「ニプロ」**  
 (持続性AT<sub>1</sub>レセプターブロッカー)

アジルサルタン錠20mg「ニプロ」について、下記の省令等に準じ、標準製剤を対照とした生物学的同等性試験(溶出試験及び血中濃度測定)を実施した。

- 後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(平成9年12月22日 医薬審第487号、平成13年5月31日一部改正 医薬審発第786号、平成18年11月24日一部改正 薬食審査発第1124004号、平成24年2月29日一部改正 薬食審査発0229第10号及び令和2年3月19日一部改正 薬食審査発0319第1号)(以下、同等性試験ガイドライン)

**I. 試料**

試験製剤: アジルサルタン錠20mg「ニプロ」  
 (1錠中にアジルサルタン20mg 含有)  
 標準製剤: アジルバ錠20mg  
 (1錠中にアジルサルタン20mg 含有)

**II. 試験**

1. 溶出試験

1) 試験条件

試験方法	回転数	試験液	試験液量	温度	製剤の投与数
パドル法	50 rpm	pH 1.2	900mL	37±0.5°C	1錠/1ベッセル
		pH 5.0			
		pH 6.8			
		水			
	100 rpm	pH 6.8			

2) 試験結果

試験液	標準製剤の平均溶出率	試験製剤の平均溶出率	判定
pH 1.2 (50 rpm)	30分以内に平均85%以上溶出せず、規定された試験時間において50%に達しなかった	標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±9%の範囲にあった	適
pH 5.0 (50 rpm)	30分以内に平均85%以上溶出せず、規定された試験時間において50%に達しなかった	標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±9%の範囲にあった	適
pH 6.8 (50 rpm)	15~30分に平均85%以上溶出した	標準製剤の平均溶出率が60%及び85%付近となる適当な2時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあるか、又はf <sub>2</sub> 関数の値が42以上であった	適
水 (50 rpm)	30分以内に平均85%以上溶出せず、規定された試験時間において50%に達しなかった	標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±9%の範囲にあった	適
pH 6.8 (100 rpm)	15分以内に平均85%以上溶出した	15分以内に平均85%以上溶出した	適

同等性試験ガイドラインに従ってアジルサルタン錠20mg「ニプロ」と標準製剤(アジルバ錠20mg)の溶出挙動を比較した。その結果、全ての条件において溶出挙動の類似性の判定基準を満たしていたため、両製剤の溶出挙動は類似していると判断した。

各試験条件における試験製剤及び標準製剤の平均溶出曲線 (Mean±S.D., n=12)

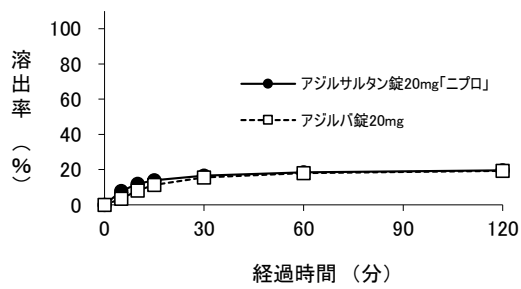


図1-1 試験液: pH 1.2 (パドル法、50 rpm)

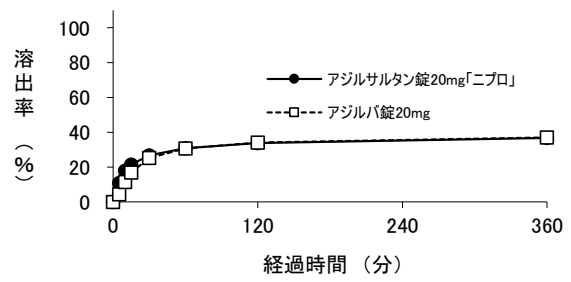


図1-2 試験液: pH 5.0 (パドル法、50 rpm)

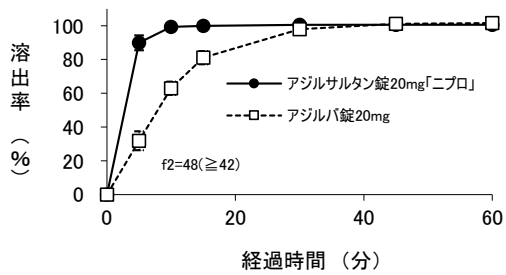


図1-3 試験液: pH 6.8 (パドル法、50 rpm)

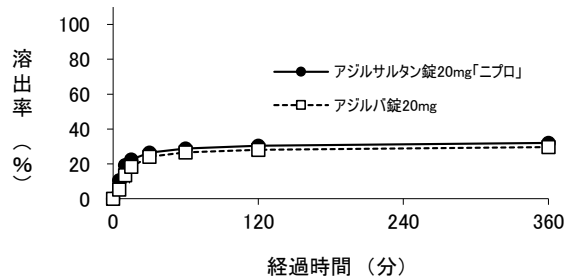


図1-4 試験液: 水 (パドル法、50 rpm)

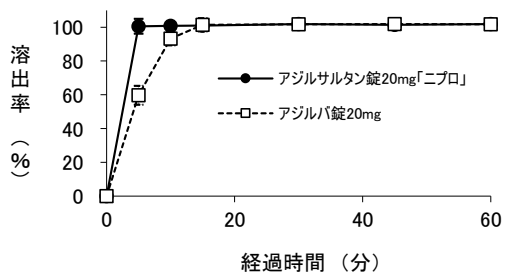


図1-5 試験液: pH 6.8 (パドル法、100 rpm)

2. 血中濃度測定及び統計解析

1) 治験の実施

被験者	日本人の健康成人男子志願者	(n=23)
試験製剤	アジルサルタン錠20mg「ニプロ」:	1錠
標準製剤	アジルバ錠20mg:	1錠
投与量	アジルサルタンとして20mg	
投与条件	クロスオーバー法 (休業期間: 14日間以上) 10時間以上の絶食後、水150mLと共に単回経口投与した。	
採血時間	0、0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、6、8、12、24、48	
測定対象物質	アジルサルタン	
測定方法	LC/MS法	

2) 結果

(1) 血漿中濃度測定 (Mean±S.D., n=23)

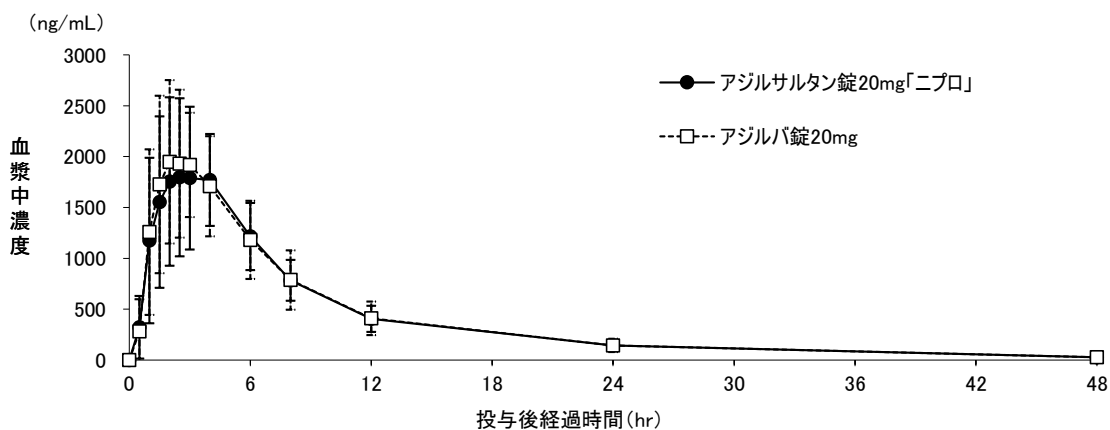


図2 血漿中アジルサルタン濃度推移

(2) 統計解析

表1 薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0→48hr</sub> (ng·hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
試験製剤	18246±3870	2325±359	2.8±1.4	9.1±1.9
標準製剤	18513±4817	2377±480	2.7±1.3	9.1±1.9

(Mean±S.D., n=23)

血漿中濃度並びにAUC、C<sub>max</sub>等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

表2 生物学的同等性判定パラメータ

平均値の差の90%信頼区間		判定
AUC <sub>0→48hr</sub>	log(0.96) ~ log(1.03)	適
C <sub>max</sub>	log(0.91) ~ log(1.08)	適

得られた薬物動態パラメータ(AUC<sub>0→48hr</sub>及びC<sub>max</sub>)について90%信頼区間法にて統計解析を実施した結果、log(0.80)~log(1.25)の範囲内であり、両製剤は生物学的に同等であると判断した。