

平成 28 年 3 月

お客様 各位



ニプロ株式会社

透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」


目止めチューブ仕様変更の件

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、目止めチューブの仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- チューブ先端の目止め部分に突起をもたせる。
- 変更理由
生産性向上及び品質向上のため

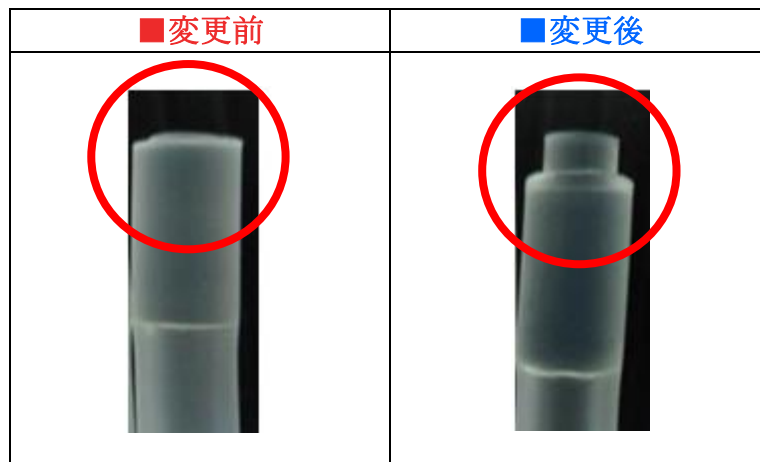

変更開始ロット

変更開始ロット： 16C02

※在庫数の関係上、ご施設様によって変更時期が前後する可能性があります。