

包装変更のご案内

ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL 「ニプロ」
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL 「ニプロ」
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL 「ニプロ」
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL 「NP」
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL 「NP」


謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、このたび標題製品の包装を変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。
 何卒ご理解の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 変更内容

取り間違えの防止対策として、シリンジラベルの記名欄を拡大し、デザインを変更します。

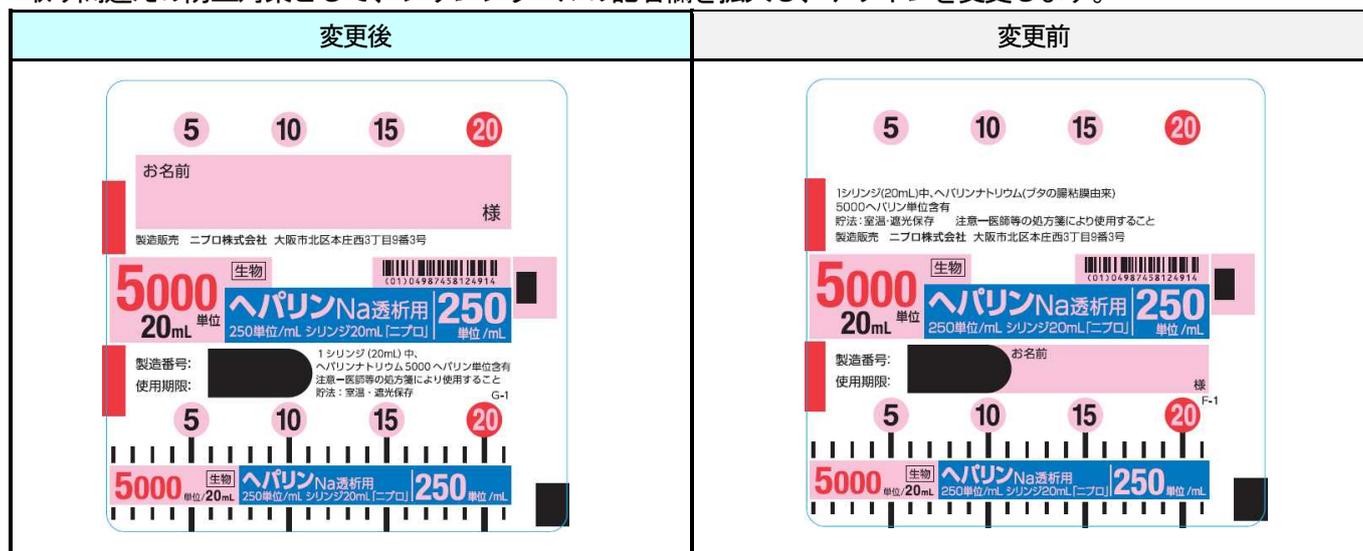

2. 変更ロット及び出荷予定時期

製品名	包装	商品コード	統一商品コード	変更ロット	出荷予定時期
ヘパリンNa透析用250単位/mL シリンジ12mL「ニプロ」	12mL×50シリンジ	12480	458-12480-8	16J08	2016年7月上旬
ヘパリンNa透析用250単位/mL シリンジ16mL「ニプロ」	16mL×50シリンジ	12485	458-12485-3	16K06	2016年8月下旬
ヘパリンNa透析用250単位/mL シリンジ20mL「ニプロ」	20mL×50シリンジ	12490	458-12490-7	16K16	2016年7月中旬
ヘパリンNa透析用500単位/mL シリンジ10mL「NP」	10mL×50シリンジ	12540	458-12540-9	16K17	2016年8月上旬
ヘパリンNa透析用500単位/mL シリンジ20mL「NP」	20mL×50シリンジ	12545	458-12545-4	16K04	2016年9月上旬

※出荷時期につきましては、若干の差異があると存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

以上