

## 「シリコーンフォーリーカテーテル」バルーン容量5mL(14~26Fr) 販売終了のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、この度「シリコーンフォーリーカテーテル」バルーン容量5mL(14~26Fr)を販売を終了いたしますので下記のとおりご案内いたします。  
後継品としまして、10mL容量を新発売いたしますので、引き続きご使用くださいますようお願い申し上げます。  
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。  
敬具

記

### 終了規格

医療機器認証番号:220ADBZX00112000 クラス分類:クラスⅡ(管理医療機器)


商品コード <sup>*</sup>	規格	サイズ <sup>*</sup> ・バルーン容量	JANコード <sup>*</sup>	終了時期(見込み)
25-464	SB2-14-5	14Fr・5mL	4987458254642	平成29年3月下旬
25-465	SB2-16-5	16Fr・5mL	4987458254659	平成29年3月中旬
25-466	SB2-18-5	18Fr・5mL	4987458254666	平成29年4月上旬
25-467	SB2-20-5	20Fr・5mL	4987458254673	平成29年4月下旬
25-468	SB2-22-5	22Fr・5mL	4987458254680	平成29年5月下旬
25-469	SB2-24-5	24Fr・5mL	4987458254697	平成29年6月中旬
25-470	SB2-26-5	26Fr・5mL	4987458254703	平成29年4月中旬

### 後継規格

医療機器認証番号:220ADBZX00112000 クラス分類:クラスⅡ(管理医療機器)

商品コード <sup>*</sup>	規格	サイズ <sup>*</sup> ・バルーン容量	JANコード <sup>*</sup>
25-509	SB2-14-10	14Fr・10mL	4987458255090
25-510	SB2-16-10	16Fr・10mL	4987458255106
25-511	SB2-18-10	18Fr・10mL	4987458255113
25-512	SB2-20-10	20Fr・10mL	4987458255120
25-513	SB2-22-10	22Fr・10mL	4987458255137
25-514	SB2-24-10	24Fr・10mL	4987458255144
25-515	SB2-26-10	26Fr・10mL	4987458255151

新旧画像

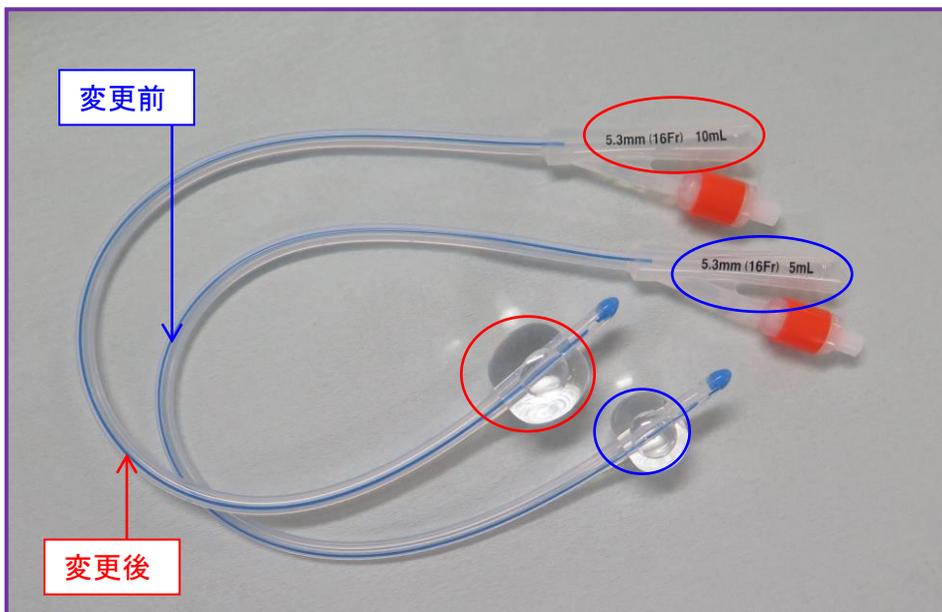

1年間、バルーン容量10mLのタグを取り付けます。

以上