

お客様 各位

2018 年 9 月
ニプロ株式会社

「バイオセンサーズ社製 電極カテーテル」 販売元変更に伴うラベル表記変更について

謹啓 時下 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社より販売しております「バイオセンサーズ社製 電極カテーテル」におきまして、販売元が(株)グッドマンからニプロ(株)に変更となることに伴い、販売企業名とロゴカラーを変更しますのでお知らせ致します。

当面従来品と混在することとなり、ご迷惑をお掛けしますがご理解の程、宜しくお願い致します。
今後とも、従来に増しますご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

対象商品・対象モデル

商品コード	発注用コード	商品名
42-411	P2502JT	ｲﾝｼﾞｬｰｼﾝｸﾞ P2502JT
42-413	P2502ST	ｲﾝｼﾞｬｰｼﾝｸﾞ P2502ST
42-412	P2502SST	ｲﾝｼﾞｬｰｼﾝｸﾞ P2502SST
42-414	PY2502JT	ｲﾝｼﾞｬｰｼﾝｸﾞ PY2502JT
42-416	PY2502ST	ｲﾝｼﾞｬｰｼﾝｸﾞ PY2502ST
42-415	PY2502SST	ｲﾝｼﾞｬｰｼﾝｸﾞ PY2502SST

●販売名：電極カテーテル

●承認番号：21200BZY00329000

変更内容

- 販売企業名の変更とロゴカラー（緑→青）が変更されます。
- ※ 別紙 赤枠部分


変更時期

- 2018 年 9 月以降、モデル毎、旧記載内容の在庫が無くなり次第切り替わります。

以上

(別紙)


【5 本入り外箱】

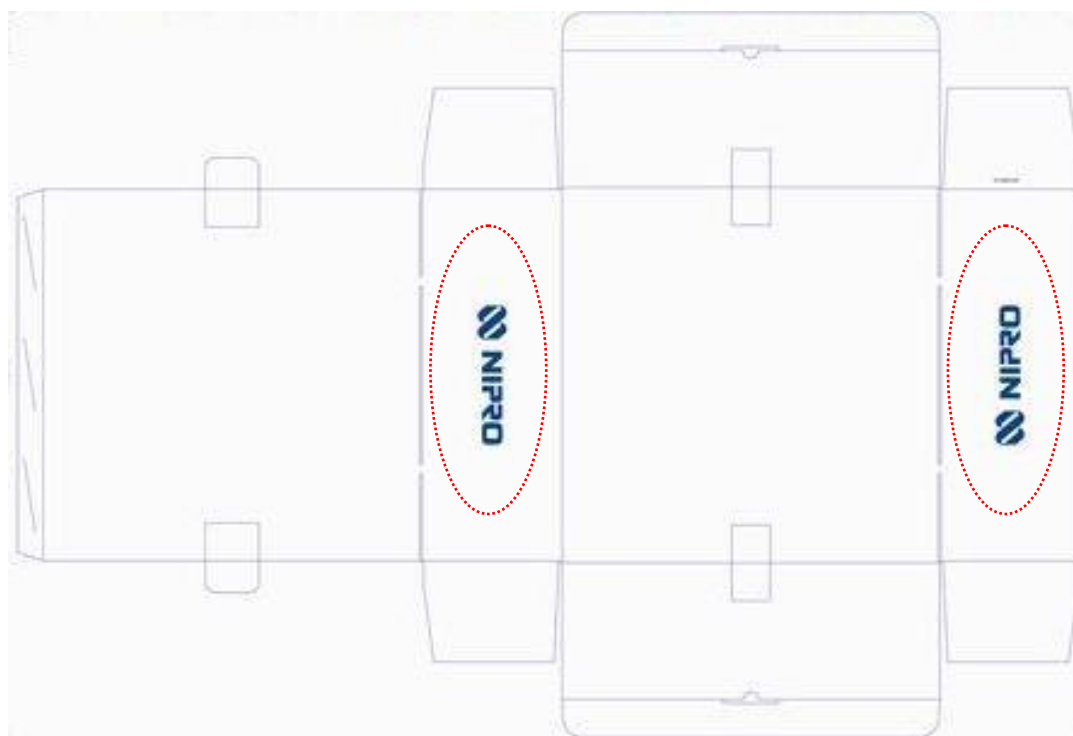

【製品箱】



【製品タイプバック面】

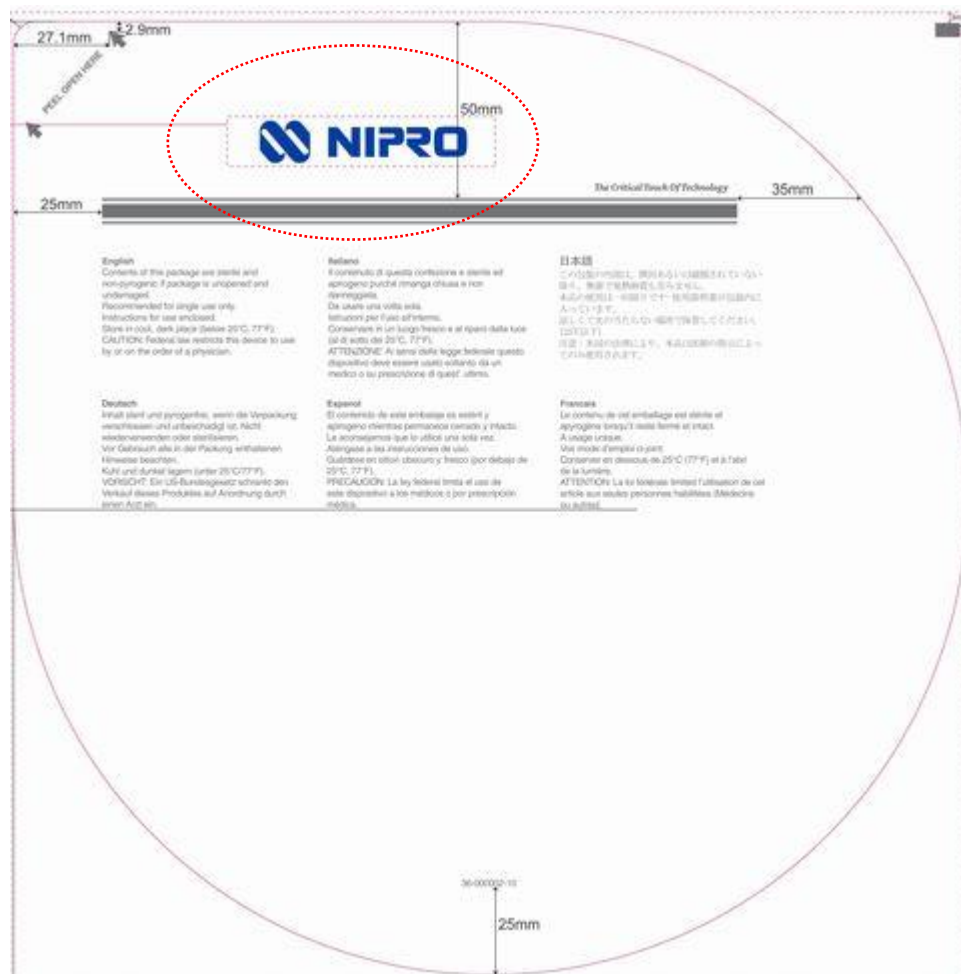

【製品仕様ラベルシール】



品番: BP####

P/N BP-XXXX-XXX REV. X

入数: 1/PKG

LOT H123456789

2000-00-00 使用期限: 2000-00-00

再使用禁止
高度管理医療機器

STERILE EO

FEATURES:
* Length ### cm
* Electrode spacing (10mm)
* PU

#F BIPOLAR PACING CATHETER WITH BALLOON

販売名: 電極カテーテル

一般的名称: バルーン付ペースメーカー向け循環器用カテーテル

有効長: ###cm フレキシブル: #F 電極間隔: 10mm

医療機器承認番号: 21200BZY00329000

製造販売: 日本バイオセンサース株式会社

東京都千代田区内幸町 1-1-7 NBF 日比谷ビル

販売: ニプロ株式会社

医療材料機能区分: 体外式ペースメーカー用カテーテル電極


(1)一時的ペースメーカー型

This product contains natural rubber Latex which may cause allergic reactions in some individuals.

Non-pyrogenic in unopened undamaged package. Store in a cool dark place.

Manufactured By
BIOSENSORS INTERNATIONAL PTE LTD
36 Jalan Tukang, Singapore 619266

LABEL P/N: LDBP-XXXX-XXX REV. X

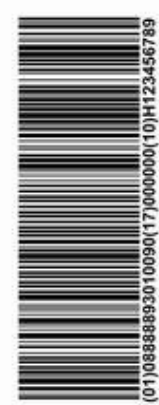

(01)08888893010090(17)000000(10)H123456789

【箱ラベルシール】

NIPRO	双極バルーンペーシング カテーテル	5F	Jカーブ 有効長 110 cm 〔大腿静脈挿入用〕
--------------	-------------------	-----------	------------------------------

NIPRO	双極バルーンペーシング カテーテル	5F	ストレート 有効長 110 cm 〔経上大静脈挿入用〕
--------------	-------------------	-----------	--------------------------------

NIPRO	双極バルーンペーシング カテーテル	5F	ストレート 有効長 90 cm 〔経上大静脈挿入用〕
--------------	-------------------	-----------	-------------------------------