


「セーフタッチ®EX チューブT」  
 内箱包材変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度「セーフタッチ EX チューブ T」の内箱包材変更を行いますのでご案内申し上げます。引き続きご愛顧の程宜しく願い申し上げます。 敬具

変更内容

●内箱の包材仕様を変更します。

一時的に包材在庫が品薄となったため、「セーフタッチ®輸液システム」の印がラベル貼付になります。  
 ※7月製造分以降は、元通り内箱への印刷に戻ります。

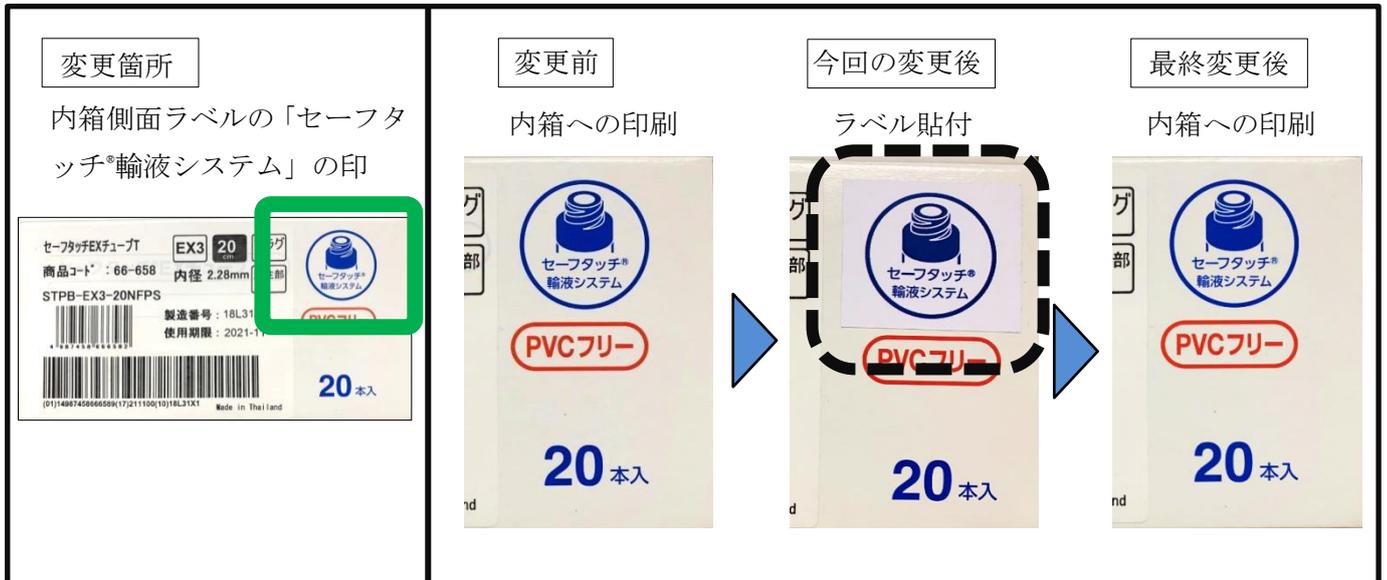

対象品番

商品コード	JAN コード	品番	今回変更のロット	流通時期	最終変更のロット	流通時期
07-700	4987458077005	STPBEX1-10NFS-T	19F ロット	7 月以降	19G ロット以降	未定
07-710	4987458077104	STPBEX1-150NFS	19D26F3	7 月中旬		
07-719	4987458077197	STPBEX3-50MFPS-2	19D30F1	7 月中		
66-499	4987458664991	STPBEX3-20PFPS1	19E31F2	7 月中		
66-635	4987458666353	STPBEX1-20NFRCS	19F ロット	7 月以降		
66-641	4987458666414	STPBEX1-50NFRCS	19D26F4	6 月中旬		
66-645	4987458666452	STPBEX1-20NFS	19F ロット	7 月以降		
66-660	4987458666605	STPBEX3-50APS	19F ロット	7 月以降		